

Bureau Veritas Exploitation

2 Rue Max Frouin
BP 30514
98800 NOUMEA

bertrand.simon@bureauveritas.com

A l'attention de :

Marie-Claire CHATAIN
PROMED
Site de l'incinérateur
BP 958
98845 NOUMEA

Suivi de préleveur de dioxines en semi-continu Rapport de mesures

Site de : PROMED - Site de l'incinérateur

Installations : Ligne 1

**Intervention du : 18/08/2025
au : 15/09/2025**

Lieu d'intervention :
Site de l'incinérateur
BP 958
98845 NOUMEA

Rédigé le : 31 octobre 2025
Référence : 25119768_9_1_1 rev 0

Rédacteur : Bertrand SIMON et Florian NAVEAU



Vérificateur : 0

Bureau Veritas Exploitation SAS - capital social de 36 315 050 euros - Siège social – 4 Place des Saisons – 92400 COURBEVOIE - RCS Nanterre B 790 184 675

Réf. : RAP-EA-Dioxcont V9 (v09-2023)

© Bureau Veritas Exploitation - Toute reproduction interdite

1 RESULTATS ET CONCLUSIONS

La concentration mesurée sur la période de référence pour chaque installation est de :

Installation	Concentration mesurée (ng/Nm ³ sec I-Teq NATO 1988 à 11 % O ₂)	VLE Concentration (ng/Nm ³ sec I-Teq NATO 1988 à 11 % O ₂)	Flux (mg/jour) *	VLE Flux (mg/jour)	Flux (ng/t _{OM})	Respect des VLE **
Ligne 1	0,188	0,10	0,024	-	-	NON

* : Le flux journalier est calculé à partir de la concentration de polluants sur la durée d'échantillonnage de la période considérée et du débit moyen du site (issu des données du site sur la même période).

** : Le respect des VLE est donné à titre indicatif sans tenir compte des incertitudes de mesures. En cas de dépassement, il appartient au client de faire réaliser une mesure ponctuelle de dioxines et furanes dans les plus brefs délais.

L'incertitude analytique s'élève à 15%. Elle ne prend pas en compte l'incertitude du système de prélèvement faisant l'objet du contrôle.

Lorsque le résultat analytique est inférieur à la limite de quantification (LQ), le calcul est effectué avec LQ/2.

Lorsque le résultat analytique est inférieur à la limite de détection (LD), le calcul est effectué avec 0.

Le système de prélèvement n'étant pas sous assurance qualité (au sens du § 6 de la norme GA X 43-139), l'accréditation COFRAC du présent rapport ne concerne que le résultat analytique (en ng) mais pas la concentration mesurée (en ng I-Teq/Nm³).



2 CONTEXTE

Dans le cadre de l'auto-surveillance des émissions atmosphériques de son installation, la société PROMED a missionné BUREAU VERITAS pour le suivi mensuel des émissions de dioxines et furanes.

L'intervention a été réalisée à :

Site de l'incinérateur
BP 958
98845 NOUMEA

Le présent document présente les résultats de la campagne d'analyse.

Le rapport d'analyse du laboratoire est présenté en fin de rapport.

L'ensemble des informations relevées sur les appareils n'est pas reporté dans ce rapport (masse volumique et pression des fumées, température et index compteurs, etc...). Ces informations sont tracées dans nos outils et transmissibles sur simple demande.

Méthodologie et contexte réglementaire :

- Arrêté du 20 septembre 2002 modifié relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets dangereux
- Arrêté du 20 septembre 2002 modifié relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux
- LAB REF 22 – Rev 05 : Exigences spécifiques – Qualité de l'air – Emissions de sources fixes
- XP CEN/TS 1948-5 : Émissions de sources fixes — Détermination de la concentration massique en PCDD/PCDF et PCB de type dioxine — Partie 5 : Prélèvement à long terme de PCDD/PCDF et PCB
- GA X43-139 : Émissions de sources fixes - Guide pour les tests de performance et de suivi périodique des systèmes de mesure en semi-continu des PCDD/F et pour la gestion des cartouches
- Votre arrêté préfectoral



3 METHODOLOGIE

3.1 Prélèvement des échantillons :

Les échantillons sont prélevés par l'appareil en place sur le point d'émission canalisé conformément aux procédures du constructeur.

Les données de prélèvements sont extraites des appareils du client ou remis à nos services par le correspondant du site.

Correspondant(s) technique(s) du site : Marie-Claire CHATAIN

Intervenant(s) Bureau veritas sur site : Bertrand SIMON et Florian NAVEAU

3.2 Analyses pratiquées sur les échantillons :

Les analyses pratiquées sur l'échantillon portent sur les dioxines et furanes.

Les supports (cartouches, ...), fournis par le constructeur de l'appareil, sont remplis et marqués par le laboratoire (cf. rapport d'analyse du laboratoire).

La méthode analytique utilisée est indiquée dans le rapport du laboratoire analytique.

Référence des échantillons :

Installation	Type d'échantillon	Référence échantillon	Référence support
Ligne 1	Cartouche + Filtre	BV2AG4217	1894

Référence des échantillons des blancs de mesure :

Installation	Type d'échantillon	Référence échantillon	Référence support
Ligne 1	Cartouche + Filtre	BV2AG4134	1894



4 PARAMETRES DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION : Ligne 1

4.1 Données de prélèvements :

Paramètres - Préleveur : DECS - Ligne 1	Valeur relevée sur la période
Volume prélevé (Nm ³ sec)	51,2
O ₂ moyen des effluents (% sec)	11,6
Humidité moyenne des effluents (%)	11,0
Vitesse moyenne des effluents (m/s)	5,1
Débit moyen des effluents (Nm ³ /h sec @ 11% O ₂)	5 419
Température mini/moyenne/maxi des effluents (°C)	72,446 / 122,201 / 154,477
Température moyenne/maxi de filtration (°C)	100,288 / 115,142
Température moyenne/maxi de prélèvement (°C)	17,347 /
Respect de la température maximale de prélèvement	Conforme (< 125°C)
Diamètre de la buse (mm)	6
Taux d'isocinétisme moyen (%) / Conformité	100,222 / Conforme
Test de fuite avant changement de la cartouche	Conforme
Test de fuite après changement de la cartouche	Conforme
Inspection visuelle	Aucun défaut détecté

Les données d'exploitation de l'installation ci-dessus sont communiquées à Bureau Veritas par le correspondant du site qui en garantit l'exactitude.

Les relevés effectués ne sont en aucun cas une validation des performances de l'appareil.

L'appareil a du faire l'objet d'une vérification initiale lors de l'installation du préleveur (essais de performances) et doit faire l'objet d'une vérification annuelle (conformément au GA X 43-139 §6).

Il est à noter que suite à des dysfonctionnements de la sonde O₂ du site, il n'a pas été possible d'utiliser les données de l'AMS ou du DECS pour les différents calculs.

La concentration en O₂ utilisée dans les différents calculs est une valeur de repli à 10,38% convenue par l'exploitant après information des autorités.

L'exploitant doit remettre en état l'ensemble de son système de mesures (O₂ et humidité) dans les meilleurs délais afin de garantir les différents calculs permettant d'aboutir à un suivi des émissions en PCDD/DF fiable.

Voir document fourni par l'exploitant en annexe de ce rapport.

Rapport référencé : 25119768_9_1_1 rev 0

Réf. : RAP-EA-Dioxcont V9 (v09-2023)



4.2 Résultats :

Taux de disponibilité :

Période considérée pour l'installation Ligne 1 :

du : 18/08/2025 10:57

au : 15/09/2025 10:38

Les durées des différents modes de fonctionnement du préleveur sont indiquées ci dessous :

Paramètres	Ligne 1
Type de l'appareil	DECS
Identification du préleveur sur le site	PRELEVEUR 1
Durée d'arrêt normal du préleveur	465,2 heure(s)
Durée d'arrêt anormal du préleveur	0,0 heure(s)
Durée de fonctionnement du préleveur	206,5 heures
Durée de fonctionnement installation (*)	206,5 heures

(*) : Donnée exploitation

Blanc de site annuel :

Paramètres	Ligne 1
Blanc de site (ng/Nm3 sec à 11 % O2)	0,0000005
VLE (ng/Nm3 sec à 11 % O2)	0,1
Ratio Blanc de site / VLE	0,00%
Conformité du blanc de site	< 10% - Conforme

Ligne 1	 Move Forward with Confidence® Période de prélèvement		Résultats d'analyses					Données préleveur					Blanc de site			Rinçage de canne			Débit de prélèvement moyen (Nm3 sec/h)	VLE		
	DECS	Début	fin	Dioxines totales (ng)	Dioxines totales (ng/Nm3)	Dioxines totales (ng/Nm3 à 11 % O2)	Débit de l'installation (Nm3/h sec à 11% O2)	Quantité émise sur la période (mg)	O2 (%)	Volume prélevé (Nm3 sec)	Humidité (%)	Temps de fonctionnement de l'appareil (heure)	Temps de fonctionnement de l'installation (heure)	Disponibilité de mesure (%)	Blanc de site (ng)	Blanc de site (ng/Nm3 à 11 % O2)	Ratio blanc/VLE (%)	Rinçage (ng)			Rinçage (ng/Nm3 à 11 % O2)	Ratio rinçage / teneur totale (%)
2024		12/08/2024 11:01	11/09/2024 08:48	0,29	0,010	0,0116	5 395	0,006	12,2	28,4	12,3	88,9	88,9	100,0%	0,000081	0,0000004	0,0%	-	-	-	0,32	0,100
		11/09/2024 09:19	09/10/2024 13:33	0,17	0,008	0,0084	6 046	0,003	11,9	22,0	12,6	65,4	65,4	100,0%	0,000081	0,0000004	0,0%	-	-	-	0,34	0,100
		09/10/2024 13:45	06/11/2024 13:33	0,07	0,003	0,0029	5 735	0,001	12,2	27,3	13,0	84,2	84,2	100,0%	0,000081	0,0000004	0,0%	-	-	-	0,32	0,100
		06/11/2024 14:20	04/12/2024 12:04	0,08	0,003	0,0032	5 512	0,002	11,2	24,9	12,9	90,0	90,0	100,0%	0,000081	0,0000004	0,0%	-	-	-	0,28	0,100
		04/12/2024 12:29	30/12/2024 07:54	8,41	0,683	0,7873	5 362	0,174	12,3	12,3	11,9	41,2	41,2	100,0%	0,000081	0,0000005	0,0%	-	-	-	0,30	0,100
2025		30/12/2024 08:20	27/01/2025 09:17	6,14	0,305	0,3332	5 139	0,129	11,8	20,1	12,1	75,6	75,6	100,0%	0,000081	0,0000004	0,0%				0,27	0,100
		04/02/2025 07:17	03/03/2025 09:17	4,24	0,186	0,1904	5 268	0,09	11,2	22,8	12,3	90,0	90,0	100,0%	0,000081	0,0000004	0,0%				0,25	0,100
		03/03/2025 10:15	31/03/2025 08:45	0,61	0,022	0,0222	5 355	0,01	11,2	28,1	11,4	111,0	111,0	100,0%	0,000081	0,0000004	0,0%				0,25	0,100
		31/03/2025 09:15	29/04/2025 08:39	0,55	0,017	0,0163	5 608	0,01	10,6	32,2	13,1	131,7	131,7	100,0%	0,000081	0,0000004	0,0%				0,24	0,100
		29/04/2025 09:04	26/05/2025 07:49	0,42	0,020	0,019	4 991	0,01	10,5	20,9	11,5	96,5	96,5	100,0%	0,000081	0,0000004	0,0%				0,22	0,100
		26/05/2025 08:40	24/06/2025 07:49	0,76	0,034	0,041	4 495	0,02	12,7	22,2	12,6	93,0	93,0	100,0%	0,000081	0,0000005	0,0%				0,24	0,100
		24/06/2025 09:15	21/07/2025 11:38	3,72	0,088	0,098	5 083	0,08	12,0	42,1	13,6	170,3	170,3	100,0%	0,000081	0,0000005	0,0%				0,25	0,100
		21/07/2025 11:47	18/08/2025 10:07	3,72	0,256	0,275	5 169	0,09	11,7	14,5	12,0	60,3	60,3	100,0%	0,000081	0,0000005	0,0%				0,24	0,100
		18/08/2025 10:57	15/09/2025 10:38	9,078	0,177	0,188	5 419	0,21	11,6	51,2	11,0	206,5	206,5	100,0%	0,000081	0,0000005	0,0%				0,25	0,100
			MOYENNE		0,143	TOTAL	0,838						Objectif > 85%				Objectif < 10%				Objectif < 10%	

Sur une année, le temps cumulé d'indisponibilité du dispositif ne peut excéder 15% du temps de fonctionnement de l'installation. Le taux cumulé de disponibilité calculé ci-dessus couvre les périodes pour lesquelles les cartouches ont été installées. Cette période globale ne correspond pas systématiquement à une année calendaire exacte, mais permet de s'assurer que le taux d'indisponibilité global est néanmoins respecté.

Les quantités de PCDD/F sont exprimés en I-Teq NATO 1988.

La quantité de polluants émise sur la période est calculée à partir de la concentration (en ng/Nm3 à 11% O2), du débit (en Nm3/h sec à 11%O2) et de la durée de fonctionnement de l'installation sur la période considérée.


Le ratio "rinçage / teneur totale" est calculé à partir des dioxines recueillies depuis le rinçage précédent.

DETAIL DES CONGENERES


Période considérée pour l'installation Ligne 1 :

du : 18/08/2025 10:57
au : 15/09/2025 10:38

Congénère	Teneur (ng)	Concentration (ng/Nm ³ sec à 11% O ₂)	Proportion (%)
PCDD/PCDF	9,078	0,1878	100%
2,3,7,8-TeCDD	2,240	0,0463	24,7%
1,2,3,7,8-PeCDD	1,430	0,0148	7,9%
1,2,3,4,7,8-HxCDD	0,265	0,0005	0,3%
1,2,3,6,7,8-HxCDD	0,433	0,0009	0,5%
1,2,3,7,8,9-HxCDD	0,323	0,0007	0,4%
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	1,350	0,0003	0,1%
OcCDD	1,950	0,0000	0,0%
2,3,7,8-TeCDF	16,000	0,0331	17,6%
1,2,3,7,8-PeCDF	7,140	0,0074	3,9%
2,3,4,7,8-PeCDF	6,810	0,0704	37,5%
1,2,3,4,7,8-HxCDF	1,920	0,0040	2,1%
1,2,3,6,7,8-HxCDF	2,410	0,0050	2,7%
2,3,4,6,7,8-HxCDF	1,750	0,0036	1,9%
1,2,3,7,8,9-HxCDF	0,000	0,0000	0,0%
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	3,100	0,0006	0,3%
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	0,388	0,0001	0,0%
OcCDF	1,020	0,0000	0,0%

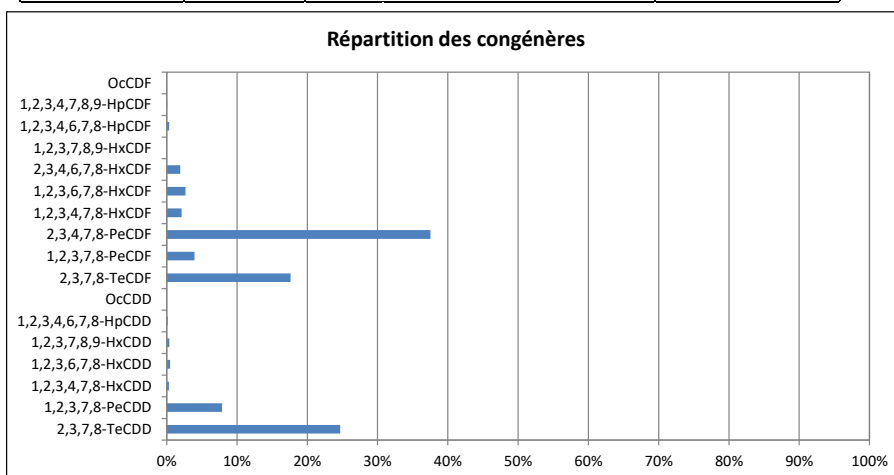

SUIVI ANNUEL

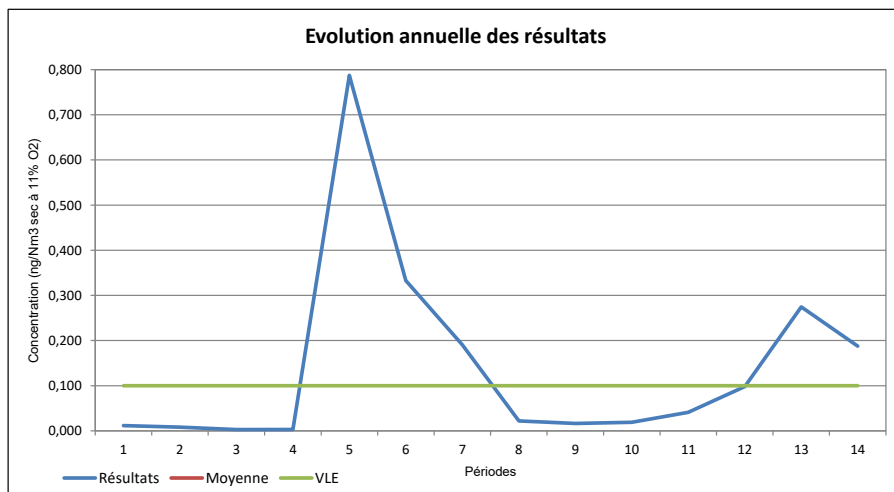

Move Forward with Confidence®

Rapport référencé : 25119768_9_1_1 rev 0

Réf. : RAP-EA-Dioxcont V9 (v09-2023)

4.3 Détails des interruptions de prélèvement :

Interruptions de prélèvement - Ligne 1			
Date de début de prélèvement		18/08/2025 10:57	
Date de fin de prélèvement		15/09/2025 10:38	
Listing des interruptions (*)			
Début	Fin	Durée (heures)	Cause / Impact
18/8/25 14:54	19/8/25 14:33	23,7	stand-by démarrage
19/8/25 21:38	20/8/25 7:17	9,6	stand-by démarrage
20/8/25 21:47	21/8/25 14:22	16,6	stand-by démarrage
21/8/25 21:32	22/8/25 6:47	9,2	stand-by démarrage
22/8/25 15:43	25/8/25 10:08	66,4	stand-by démarrage
25/8/25 11:03	25/8/25 13:18	2,3	stand-by démarrage
25/8/25 14:05	25/8/25 16:20	2,3	stand-by démarrage
25/8/25 17:22	26/8/25 10:10	16,8	stand-by démarrage
26/8/25 21:35	27/8/25 7:12	9,6	stand-by démarrage
27/8/25 21:27	28/8/25 7:10	9,7	stand-by démarrage
28/08/2025 21:25	29/08/2025 07:22	9,9	stand-by démarrage
29/08/2025 17:52	01/09/2025 17:07	71,3	stand-by démarrage
01/09/2025 22:11	02/09/2025 07:02	8,9	stand-by démarrage
02/09/2025 22:17	03/09/2025 07:02	8,7	stand-by démarrage
03/09/2025 21:24	04/09/2025 08:09	10,7	stand-by démarrage
04/09/2025 20:36	05/09/2025 07:51	11,3	stand-by démarrage
05/09/2025 18:52	09/09/2025 09:09	86,3	stand-by démarrage
09/09/2025 21:39	10/09/2025 07:14	9,6	stand-by démarrage
10/09/2025 21:35	11/09/2025 07:20	9,7	stand-by démarrage
11/09/2025 21:40	12/09/2025 07:10	9,5	stand-by démarrage
12/09/2025 17:49	15/09/2025 09:24	63,6	stand-by démarrage

(*) : Seules les principales interruptions (supérieures à une heure par exemple) sont listées ci-dessus, les autres sont consultables dans le fichier de suivi de l'appareil.

Rapport référencé : 25119768_9_1_1 rev 0

Réf. : RAP-EA-Dioxcont V9 (v09-2023)

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Bertrand SIMON
ZA Lenfant
405 Rue Emilien Gautier - Les Milles
13290 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 25R027212

Version du : 20/10/2025

N° de rapport d'analyse : AR-25-N8-028217-01

Date de réception technique : 06/10/2025

Première date de réception physique : 06/10/2025

Référence Dossier :

Référence Commande : 1510797081/25119768/25199

Coordinateur de Projets Clients : Marjorie Grimault / MarjorieGrimault@eurofins.com / +33 6 47 65 67 63

N° Ech	Matrice	Référence échantillon
001	Air Emission (AIE)	BV2AG4217

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 25R027212

Version du : 20/10/2025

N° de rapport d'analyse : AR-25-N8-028217-01

Date de réception technique : 06/10/2025

Première date de réception physique : 06/10/2025

Référence Dossier :

Référence Commande : 1510797081/25119768/25199

N° Echantillon

001

Référence client :

BV2AG4217

Matrice :

AIE

Date de prélèvement :

Date de début d'analyse :

09/10/2025

Sous-traitance | Eurofins GfA Lab Service GmbH (Hamburg)

GFU01 : **Dioxins(17 PCDD/F) ~ Environnement - Air**

2,3,7,8-TCDD	ng/échantillon	2.24 ±30%
1,2,3,7,8-PeCDD	ng/échantillon	1.43 ±30%
1,2,3,4,7,8-HxCDD	ng/échantillon	0.265 ±30%
1,2,3,6,7,8-HxCDD	ng/échantillon	0.433 ±30%
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	ng/échantillon	1.35 ±30%
1,2,3,7,8,9-HxCDD	ng/échantillon	0.323 ±30%
2,3,7,8-TCDF	ng/échantillon	16.0 ±30%
1,2,3,7,8-PeCDF	ng/échantillon	7.14 ±30%
2,3,4,7,8-PeCDF	ng/échantillon	6.81 ±30%
1,2,3,4,7,8-HxCDF	ng/échantillon	1.92 ±30%
1,2,3,6,7,8-HxCDF	ng/échantillon	2.41 ±30%
1,2,3,7,8,9-HxCDF	ng/échantillon	ND, <0.159
2,3,4,6,7,8-HxCDF	ng/échantillon	1.75 ±30%
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	ng/échantillon	3.10 ±30%
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	ng/échantillon	0.388 ±30%
OCDD	ng/échantillon	1.95 ±30%
OCDF	ng/échantillon	1.02 ±30%
TR 13C12-2,3,7,8-TetraCDF	%	59.8
TR 13C12-2,3,4,7,8-PentaCDF	%	66.6
TR 13C12-1,2,3,4,7,8-HexaCDF	%	64.8
TR 13C12-1,2,3,6,7,8-HexaCDF	%	57.1
TR 13C12-2,3,4,6,7,8-HexaCDF	%	62.8
TR 13C12-1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF	%	58.8
RR 13C12-OctaCDF	%	55.9
TR 13C12-2,3,7,8-TetraCDD	%	61.6
TR 13C12-1,2,3,7,8-PentaCDD	%	65.9
TR 13C12-1,2,3,4,7,8-HexaCDD	%	68.1
TR 13C12-1,2,3,6,7,8-HexaCDD	%	65.8
RR 13C12-1,2,3,7,8,9-HexaCDD	%	100

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 25R027212

Version du : 20/10/2025

N° de rapport d'analyse : AR-25-N8-028217-01

Date de réception technique : 06/10/2025

Première date de réception physique : 06/10/2025

Référence Dossier :

Référence Commande : 1510797081/25119768/25199

N° Echantillon

001

Référence client :

BV2AG4217

Matrice :

AIE

Date de prélèvement :

Date de début d'analyse :

09/10/2025

Sous-traitance | Eurofins GfA Lab Service GmbH (Hamburg)

GFU01 : **Dioxins(17 PCDD/F) ~ Environnement - Air**

TR 13C12-1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD	%	56.3
TR 13C12-OctaCDD	%	55.3
TR 13C12-1,2,3,4-TetraCDD	%	100
Dioxines et furanes (OMS 2005 PCDD/F-TEQ) avec LQ	ng/échantillon	8.30 ±25%
Dioxines et furanes (OMS 2005 PCDD/F-TEQ) sans LQ	ng/échantillon	8.29 ±25%
Dioxines et furanes (OMS 2005 PCDD/F-TEQ) 1/2 LQ	ng/échantillon	8.30 ±25%
Tx de réapparition 13C12-12378-PentaCDF	%	104
Tx de réapparition 13C12-123789-HexaCDF	%	92.3
Tx de réapparition 13C12-1234789-HptCDF	%	96.3
I-TEQ (NATO/CCMS) incl. 1/2 LOQ	ng/échantillon	9.09 ±25%
I-TEQ (NATO/CCMS) sans LQ	ng/échantillon	9.08 ±25%
I-TEQ (NATO/CCMS) avec LQ	ng/échantillon	9.10 ±25%

GFTE2 : **TEQ PCDD/F - NF X 43-551**

WHO(2005)-PCDD/F TEQ (NF X 43-551)	ng/échantillon	8.29
I-TEQ (NATO/CCMS) (NF X 43-551)	ng/échantillon	9.08

D : détecté / ND : non détecté

z2 ou (2) : zone de contrôle des supports

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 25R027212

Version du : 20/10/2025

N° de rapport d'analyse : AR-25-N8-028217-01

Date de réception technique : 06/10/2025

Première date de réception physique : 06/10/2025

Référence Dossier :

Référence Commande : 1510797081/25119768/25199

**Marjorie Grimault**

Coordinateur(rice) Projets Clients EAA

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats et conclusions éventuelles s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. Les données transmises par le client pouvant affecter la validité des résultats (la date de prélèvement, la matrice, la référence échantillon et autres informations identifiées comme provenant du client), ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire. L'information relative au seuil de détection d'un paramètre n'est pas couverte par l'accréditation Cofrac.

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Tous les éléments de traçabilité et incertitude (déterminée avec $k = 2$) sont disponibles sur demande.

Dans le cas d'analyse d'Air à l'Emission : Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées conformément à l'arrêté du 11 Mars 2010. Mention des types d'analyses pour lesquels l'agrément a été délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.

N° de rapport d'analyse : AR-25-N8-028217-01

Commande EOL :

Référence commande : 1510797081/25119768/25199

[illegible]

Annexe technique

Dossier N° :25R027212

N° de rapport d'analyse : AR-25-N8-028217-01

Emetteur :

Commande EOL :

Nom projet :

Référence commande : 1510797081/25119768/25199

Air Emission

Code	Analyse	Principe et référence de la méthode	LQI	Incertitude à la LQ	Unité	Prestation réalisée sur le site de :
	TR 13C12-OctaCDD				%	
	TR 13C12-1,2,3,4-TetraCDD				%	
	Dioxines et furanes (OMS 2005 PCDD/F-TEQ) avec LQ				ng/échantillon	
	Dioxines et furanes (OMS 2005 PCDD/F-TEQ) sans LQ				ng/échantillon	
	Dioxines et furanes (OMS 2005 PCDD/F-TEQ) 1/2 LQ				ng/échantillon	
	Tx de réapparition 13C12-12378-PentaCD				%	
	Tx de réapparition 13C12-123789-HexaCl				%	
	Tx de réapparition 13C12-1234789-HptCC				%	
	I-TEQ (NATO/CCMS) incl. 1/2 LOQ				ng/échantillon	
	I-TEQ (NATO/CCMS)) sans LQ				ng/échantillon	
	I-TEQ (NATO/CCMS) avec LQ				ng/échantillon	

Annexe de traçabilité des échantillons

Cette traçabilité recense les flacons des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 25R027212

N° de rapport d'analyse : AR-25-N8-028217-01

Emetteur :

Commande EOL :

Nom projet :

Référence commande : 1510797081/25119768/25199

Air Emission

N° Ech	Référence Client	Date & Heure Prélèvement	Date de Réception Physique (1)	Date de Réception Technique (2)	Code-Barre	Nom Flacon
001	BV2AG4217		06/10/2025	06/10/2025		

(1) : Date à laquelle l'échantillon a été réceptionné au laboratoire.

Lorsque l'information n'a pas pu être récupérée, cela est signalé par la mention N/A (non applicable).

(2) : Date à laquelle le laboratoire disposait de toutes les informations nécessaires pour finaliser l'enregistrement de l'échantillon.

Eurofins Analyses de l'Air
attn. Reports
5 rue d'Otterswiller
67700 SAVERNE
FRANKREICH

Person in charge Dr. M. Ambrosius
ASM Dr. M. Ambrosius

Report date 20.10.2025

Page 1/4

Analytical report AR-25-GF-044554-01

Sample Code 710-2025-33505001

¹Reference	Emission
	BV2AG4217 -
¹Sample sender	Reports
Reception date time	10.10.2025
Transport by	Line Haul
¹Client Purchase order nr.	EUFR7700021259
¹Purchase order date	08.10.2025
¹Client sample code	25R027212-001
Number of containers	3
Reception temperature	room temperature
End analysis	20.10.2025

¹: This information was provided by the customer. Data provided by the customer may have an impact on the validity of the test results.

Test results

GFU01	polychlorinated dibenzodioxins and -furans (17 PCDD/F): emission, immission, air (°) (#)	
Method	EN 1948*, GLS DF 140:2024-12-05, GC-HRMS	
2,3,7,8-TetraCDD	2.24	ng/sample
	± 0.671	ng/sample
1,2,3,7,8-PentaCDD	1.43	ng/sample
	± 0.430	ng/sample
1,2,3,4,7,8-HexaCDD	0.265	ng/sample
	± 0.0795	ng/sample
1,2,3,6,7,8-HexaCDD	0.433	ng/sample
	± 0.130	ng/sample

The results of examination refer exclusively to the checked samples as received.
Any publication of this report requires written permission. An excerpt publication is not allowed.
Eurofins GfA Lab Service GmbH · Neuländer Kamp 1a · D-21079 Hamburg
Headquarters: Eurofins GfA Lab Service GmbH – Neuländer Kamp 1a D-21079 Hamburg
HRB 115907 AG Hamburg
General Managers: Dr. Felix Focke
VAT No.: DE275912372
Hypovereinsbank • Bank code: 207 300 17 • Account No.: 7000002400 • SWIFT-BIC: HYVEDEMM17
IBAN: DE12 2073 0017 7000 0024 00

Our General Terms & Conditions, available upon request and online at
<http://www.eurofins.de/lebensmittel/kontakt/avb.aspx>, shall apply.

Accredited testing Laboratory by DIN EN ISO/IEC
DAKkS according to
DIN EN ISO/IEC 17025:2018
The accreditation is valid only for the scope listed in
the annex of the

1,2,3,7,8,9-HexaCDD	0.323	ng/sample
	± 0.0968	ng/sample
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD	1.35	ng/sample
	± 0.406	ng/sample
OctaCDD	1.95	ng/sample
	± 0.586	ng/sample
2,3,7,8-TetraCDF	16.0	ng/sample
	± 4.80	ng/sample
1,2,3,7,8-PentaCDF	7.14	ng/sample
	± 2.14	ng/sample
2,3,4,7,8-PentaCDF	6.81	ng/sample
	± 2.04	ng/sample
1,2,3,4,7,8-HexaCDF	1.92	ng/sample
	± 0.576	ng/sample
1,2,3,6,7,8-HexaCDF	2.41	ng/sample
	± 0.724	ng/sample
1,2,3,7,8,9-HexaCDF	(not det.) < 0,159	ng/sample
2,3,4,6,7,8-HexaCDF	1.75	ng/sample
	± 0.524	ng/sample
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF	3.10	ng/sample
	± 0.931	ng/sample
1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF	0.388	ng/sample
	± 0.116	ng/sample
OctaCDF	1.02	ng/sample
	± 0.305	ng/sample
WHO(2005)-PCDD/F TEQ (lower-bound)	8.29	ng/sample
	± 2.07	ng/sample
WHO(2005)-PCDD/F TEQ (medium-bound)	8.30	ng/sample
	± 2.07	ng/sample
WHO(2005)-PCDD/F TEQ (upper-bound)	8.30	ng/sample
	± 2.08	ng/sample
I-TEQ (NATO/CCMS) (lower-bound)	9.08	ng/sample
	± 2.27	ng/sample
I-TEQ (NATO/CCMS) (medium-bound)	9.09	ng/sample
	± 2.27	ng/sample
I-TEQ (NATO/CCMS) (upper-bound)	9.10	ng/sample
	± 2.27	ng/sample
RR 13C12-1,2,3,7,8-PentaCDF	104	%
RR 13C12-1,2,3,7,8,9-HexaCDF	92.3	%
RR 13C12-1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF	96.3	%

The results of examination refer exclusively to the checked samples as received.
Any publication of this report requires written permission. An excerpt publication is not allowed.
Eurofins GfA Lab Service GmbH · Neuländer Kamp 1a · D-21079 Hamburg
Headquarters: Eurofins GfA Lab Service GmbH – Neuländer Kamp 1a D-21079 Hamburg
HRB 115907 AG Hamburg
General Managers: Dr. Felix Focke
VAT No.: DE275912372
Hypovereinsbank • Bank code: 207 300 17 • Account No.: 7000002400 • SWIFT-BIC: HYVEDEMM17
IBAN: DE12 2073 0017 7000 0024 00

Our General Terms & Conditions, available upon request and online at
<http://www.eurofins.de/lebensmittel/kontakt/avb.aspx>, shall apply.



Accredited testing Laboratory by DIN EN ISO/IEC
DAKKS according to

DIN EN ISO/IEC 17025:2018

The accreditation is valid only for the scope listed in
the annex of the

RR 13C12-2,3,7,8-TetraCDD	61.6	%
RR 13C12-1,2,3,4-TetraCDD	100	%
RR 13C12-1,2,3,7,8-PentaCDD	65.9	%
RR 13C12-1,2,3,4,7,8-HexaCDD	68.1	%
RR 13C12-1,2,3,6,7,8-HexaCDD	65.8	%
RR 13C12-1,2,3,7,8,9-HexaCDD	100	%
RR 13C12-1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD	56.3	%
RR 13C12-OctaCDD	55.3	%
RR 13C12-2,3,7,8-TetraCDF	59.8	%
RR 13C12-2,3,4,7,8-PentaCDF	66.6	%
RR 13C12-1,2,3,4,7,8-HexaCDF	64.8	%
RR 13C12-1,2,3,6,7,8-HexaCDF	57.1	%
RR 13C12-2,3,4,6,7,8-HexaCDF	62.8	%
RR 13C12-1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF	58.8	%
RR 13C12-OctaCDF	55.9	%

GFTE2 TEQ PCDD/F acc. to NF X 43-551 (°) (#)

Method	Internal, DF:110-7/120-6/130-3/140-6, Calculation		
WHO(2005)-PCDD/F TEQ (LAB REF 22)	8.29	ng/sample	
	± 2.07	ng/sample	
I-TEQ (NATO/CCMS) (LAB REF 22)	9.08	ng/sample	
	± 2.27	ng/sample	

(°) = The test was performed at the laboratory site: Am Neuländer Gewerbepark 4

(#) = Eurofins GfA Lab Service GmbH (Hamburg) is accredited for this test.

Result +/- expanded measurement uncertainty (95%; k=2)

< - Concentration below the indicated limit of quantification (LOQ)

L.Q. = below limit of quantification

not. det. = the compound is not detected in the range below the LOQ (limit of quantification)

det. = the compound is detected in the range below the LOQ

The recovery rates of the internal standards are within the limitations of EN 1948.

*The analysis was carried out corresponding to the sampling procedure and parameters according to DIN EN 1948-2:2006-06 (Clean-up), DIN EN 1948-3:2006-06 (PCDD/F), DIN EN 1948-4:2014-03 (PCB) and DIN CEN/TS 1948-5:2015-06 (long-term sampling). Additional information regarding the processing of the samples according to DIN EN 1948-3:2006-06 (PCDD/F) and DIN EN 1948-4:2014-03 (PCB) will be made available on request.

The results of examination refer exclusively to the checked samples as received.
Any publication of this report requires written permission. An excerpt publication is not allowed.
Eurofins GfA Lab Service GmbH · Neuländer Kamp 1a · D-21079 Hamburg
Headquarters: Eurofins GfA Lab Service GmbH – Neuländer Kamp 1a D-21079 Hamburg
HRB 115907 AG Hamburg
General Managers: Dr. Felix Focke
VAT No.: DE275912372
Hypovereinsbank • Bank code: 207 300 17 • Account No.: 7000002400 • SWIFT-BIC: HYVEDEMM17
IBAN: DE12 2073 0017 7000 0024 00


Our General Terms & Conditions, available upon request and online at
<http://www.eurofins.de/lebensmittel/kontakt/avb.aspx>, shall apply.



Accredited testing Laboratory by DIN EN ISO/IEC
DAKKS according to

DIN EN ISO/IEC 17025:2018

The accreditation is valid only for the scope listed in
the annex of the



Analytical Service Manager (Dr. Michael Ambrosius)

The results of examination refer exclusively to the checked samples as received.
Any publication of this report requires written permission. An excerpt publication is not allowed.
Eurofins GfA Lab Service GmbH · Neuländer Kamp 1a · D-21079 Hamburg
Headquarters: Eurofins GfA Lab Service GmbH – Neuländer Kamp 1a D-21079 Hamburg
HRB 115907 AG Hamburg
General Managers: Dr. Felix Focke
VAT No.: DE275912372
Hypovereinsbank • Bank code: 207 300 17 • Account No.: 7000002400 • SWIFT-BIC: HYVEDEMM17
IBAN: DE12 2073 0017 7000 0024 00

Our General Terms & Conditions, available upon request and online at
<http://www.eurofins.de/lebensmittel/kontakt/avb.aspx>, shall apply.



Accredited testing Laboratory by DIN EN ISO/IEC
DAKkS according to

DIN EN ISO/IEC 17025:2018

The accreditation is valid only for the scope listed in
the annex of the

	QUA-DO-00017	15/07/2025
	TITRE :	Explication et mise en place d'une valeur de repli pour l'oxygène (O ₂) – analyseur gaz
	REDACTEUR	Marie-Claire CHATAIN : Responsable QHSE

A Nouméa, le 15/07/2025

**DIRECTION DU DEVELOPPEMENT
DURABLE DU TERRITOIRE DE LA
PROVINCE SUD
6 Route des Artifices
Baie de la Moselle
BP L1
98849 Nouméa**

A l'attention de Madame la Présidente de l'Assemblée de la Province Sud

Affaire suivie par Mme Audrey Frick-Labussière

Objet : Explication et mise en place d'une valeur de repli pour l'oxygène (O₂) – analyseur gaz

Madame,

Dans le cadre du suivi en continu de nos émissions atmosphériques, nous avons récemment identifié à nouveau, un dysfonctionnement de la sonde d'oxygène intégrée à notre analyseur gaz.

Ce dysfonctionnement, observé à partir du 26 juin 2025, se manifeste par des mesures incohérentes de la teneur en O₂ dans les gaz de combustion (valeurs anormalement élevées, parfois supérieures à 19% en fonctionnement et jusqu'à 21%), rendant impossible toute normalisation fiable des polluants réglementés tels que le HCl, le SO₂, le CO ou les NOX.

En l'absence d'une mesure correcte d'O₂, les valeurs normalisées générées par l'analyseur deviennent non représentatives et ne peuvent être exploitées à des fins réglementaires.

Dans ce contexte, et en attendant la remise en service d'une sonde fonctionnelle, nous souhaitons mettre en place une **valeur de repli pour l'oxygène**. Cette valeur permettrait de garantir la continuité du suivi environnemental, tout en assurant une cohérence des calculs de normalisation.

	QUA-DO-00017	15/07/2025
	TITRE :	Explication et mise en place d'une valeur de repli pour l'oxygène (O ₂) – analyseur gaz
	REDACTEUR	Marie-Claire CHATAIN : Responsable QHSE

La **valeur de repli proposée est de 10,28% O₂ sec**, déterminée à partir de la moyenne annuelle des teneurs en oxygène mesurées sur notre installation lors des phases normales de combustion.

Nous proposons d'appliquer cette valeur de repli dans les cas suivants :

- Lorsque la mesure d'oxygène dépasse **15% O₂ sec**, seuil considéré comme non représentatif d'un fonctionnement en combustion normale.
- La réserve du fournisseur étant que même avec un fonctionnement normale nos valeurs d'O₂ varient énormément et dépassent parfois les 15%.

Si vous validez cette approche, nous aurons besoin d'un courrier officiel de votre part, à transmettre à notre fournisseur SICK, pour que cette valeur de repli puisse être intégrée dans la configuration de l'analyseur.

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire,

Dans l'attente de votre retour, nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.

CHATAIN

Marie-Claire

Responsable QHSE